


中国



第1页 共4页

SINOENVIRON
— TESTING —

201812052000

3 / 3

检测报告

TEST REPORT

中国

中国

SINOENVIRON

中国

ENVIRON


SINO

中国

Issued Date

2018.12.05

2018.12.05

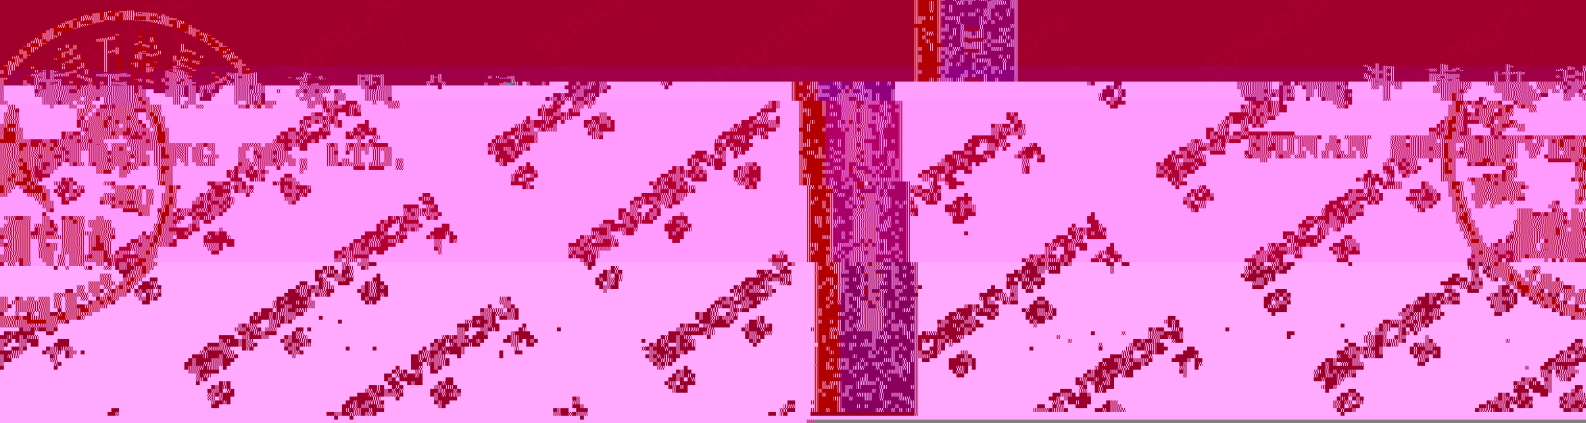

声 明

报告编号: SENT25021208-2

第 2 页, 共 4 页

1. 报告若未加盖“检验检测专用章”、无授权签发人签字, 一律无效。
2. 未加盖资质认定标志 (CMA 章) 的报告, 检测数据和结果仅供客户内部使用, 对社会不具有证明作用。

客户提供的样品, 委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。

8. 采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
9. 除客户特别声明并支付样品管理费以外, 所有样品超过规定的时效期均不再留样。

公司名称: 湖南中科茵万检测有限公司

公司地址: 湖南省长沙县开福区山鹿路八道 2450 号科创园 A-5 栋 2 层
201、204-209 号

联系电话: 0731-88189075

检测报告

报告编号: SENT25021208-2

第 3 页 共 4 页

委托单位:

检测项目:

检测地点:

检测日期:

检测人员:

审核人员:

批准人员:

报告日期:

报告版本:

报告状态:

报告备注:

报告附件:

报告说明:

报告结论:

报告总结:

报告附录:

报告索引:

报告目录:

报告封面:

报告封底:

报告内页:

报告外页:

报告附件:

报告说明:

报告结论:

报告总结:

报告附录:

报告索引:

报告目录:

报告封面:

报告封底:

报告内页:

报告外页:

报告附件:

报告说明:

报告结论:

报告总结:

报告附录:

报告索引:

报告目录:

报告封面:

报告封底:

报告内页:

报告外页:

报告附件:

报告说明:

报告结论:

报告总结:

报告附录:

报告索引:

报告目录:

报告封面:

报告封底:

报告内页:

报告外页:

报告附件:

报告说明:

报告结论:

报告总结:

报告附录:

报告索引:

报告目录:

5. 分析方法及仪器

序号	检测项目	检测方法	检测仪器	检测结果	判定标准
1	甲醛	GB 18284-2000	甲醛检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
2	苯	GB 18284-2000	苯检测仪	0.01mg/m³	≤0.03mg/m³
3	甲苯	GB 18284-2000	甲苯检测仪	0.02mg/m³	≤0.08mg/m³
4	二甲苯	GB 18284-2000	二甲苯检测仪	0.03mg/m³	≤0.10mg/m³
5	挥发性有机物	GB 18284-2000	挥发性有机物检测仪	0.10mg/m³	≤0.20mg/m³
6	总挥发性有机物	GB 18284-2000	总挥发性有机物检测仪	0.15mg/m³	≤0.30mg/m³
7	臭氧	GB 18284-2000	臭氧检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
8	二氧化碳	GB 18284-2000	二氧化碳检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
9	氨气	GB 18284-2000	氨气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
10	硫化氢	GB 18284-2000	硫化氢检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
11	一氧化碳	GB 18284-2000	一氧化碳检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
12	二氧化硫	GB 18284-2000	二氧化硫检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
13	氮氧化物	GB 18284-2000	氮氧化物检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
14	氟化氢	GB 18284-2000	氟化氢检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
15	氯气	GB 18284-2000	氯气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
16	溴气	GB 18284-2000	溴气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
17	碘气	GB 18284-2000	碘气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
18	汞蒸气	GB 18284-2000	汞蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
19	铅蒸气	GB 18284-2000	铅蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
20	镉蒸气	GB 18284-2000	镉蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
21	铬蒸气	GB 18284-2000	铬蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
22	锰蒸气	GB 18284-2000	锰蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
23	镍蒸气	GB 18284-2000	镍蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
24	铜蒸气	GB 18284-2000	铜蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
25	锌蒸气	GB 18284-2000	锌蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
26	铝蒸气	GB 18284-2000	铝蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
27	铁蒸气	GB 18284-2000	铁蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
28	锡蒸气	GB 18284-2000	锡蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
29	铋蒸气	GB 18284-2000	铋蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
30	钨蒸气	GB 18284-2000	钨蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
31	钼蒸气	GB 18284-2000	钼蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
32	铌蒸气	GB 18284-2000	铌蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
33	钽蒸气	GB 18284-2000	钽蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
34	铍蒸气	GB 18284-2000	铍蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
35	锆蒸气	GB 18284-2000	锆蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
36	铪蒸气	GB 18284-2000	铪蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
37	钽蒸气	GB 18284-2000	钽蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
38	铌蒸气	GB 18284-2000	铌蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
39	钼蒸气	GB 18284-2000	钼蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
40	钨蒸气	GB 18284-2000	钨蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
41	铋蒸气	GB 18284-2000	铋蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
42	锡蒸气	GB 18284-2000	锡蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
43	铁蒸气	GB 18284-2000	铁蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
44	铝蒸气	GB 18284-2000	铝蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
45	锌蒸气	GB 18284-2000	锌蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
46	铜蒸气	GB 18284-2000	铜蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
47	镍蒸气	GB 18284-2000	镍蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
48	铬蒸气	GB 18284-2000	铬蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
49	镉蒸气	GB 18284-2000	镉蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³
50	汞蒸气	GB 18284-2000	汞蒸气检测仪	0.05mg/m³	≤0.10mg/m³

本页结束




检测报告

报告编号: SENT25021208-2

第4页 共4页

附图 1: 采样点位示意图



图例

■ 固体废物

